


NOTICE D'UTILISATION

Armoire de Stérilisation

ARM50FA / KS20FA

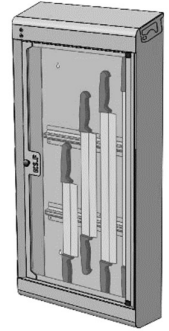

AVANT D'OUVRIRE ET D'UTILISER CET APPAREIL LIRE CES INSTRUCTIONS

LA GAMME ARM / KS : PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT

Vous venez de faire l'acquisition d'une armoire de stérilisation pour couteaux fromagers et nous espérons qu'elle vous donnera entière satisfaction.

Ces appareils ARM assurent une excellente décontamination, conformes aux exigences d'hygiène. La lampe agissant dans leur enceinte, émet un rayonnement UV-C (253nm) qui détruit les germes en tuant les cellules qui y sont exposées.

UTILISATION :

Ouvrir la porte de l'armoire et placer les couteaux secs dans l'enceinte (après les avoir nettoyés) puis refermer la porte.

ARM : Manipuler ensuite le bouton latéral de minuterie pour lancer un cycle de stérilisation en le réglant sur 2 heures, un cycle de stérilisation commence aussitôt.

Si la porte est ouverte durant un cycle, il faut régler à nouveau le cycle sur 2 heures après avoir refermé la porte.

KS : Après sa fermeture, l'armoire lance automatiquement un cycle de stérilisation de 2 heures.

Si la porte est ouverte puis refermée avant la fin d'un cycle, un cycle complet est réinitialisé.

Les deux voyants (1 rouge et 1 vert) indiquent l'état de l'armoire :

- VERT éteint + ROUGE éteint → La porte est ouverte ou pas correctement fermée.
- VERT éteint + ROUGE allumé → Un cycle de stérilisation est en cours.
- VERT allumé + ROUGE éteint → La stérilisation est terminée.

Lorsqu'un cycle est terminé, les couteaux sont stériles et prêts à être utilisés.

PRECAUTIONS INITIALES

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance (A2 / EN 60335-1). L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants (voir "EMPLACEMENT").

SECURITE PHOTOBIOLOGIQUE



Cet appareil intègre un émetteur UV-C. Ces rayonnements UV-C sont dangereux pour les yeux et la peau, même à faibles doses.

La construction de cet appareil assure la totale sécurité des utilisateurs contre ce rayonnement, dans des conditions normales d'utilisation.

En effet, lors de toute ouverture de la porte, un capteur de sécurité coupe la lampe. Une utilisation non prévue de l'appareil ou détérioration de son enveloppe peuvent entraîner des fuites du rayonnement UV-C.

Ne jamais utiliser les ampoules UVC hors de cette enceinte.

Ne pas mettre cet appareil en fonctionnement s'il est manifestement endommagé.

Ne jamais tenter d'actionner le capteur de sécurité lorsque l'enceinte est ouverte.

ALIMENTATION

Cet appareil fonctionne en **230~240V / 50~60 Hz.**, Avant sa mise en service, assurez-vous que l'alimentation de vos locaux est compatible avec cet équipement.

Cet appareil doit impérativement être raccordé à une prise électrique reliée à la terre et reliée à un disjoncteur différentiel à courant résiduel 30 mA (DDR, RCD).

EMPLACEMENT

Cette armoire est conçue exclusivement pour une utilisation en intérieur. Il convient de fixer votre armoire de stérilisation à au moins 1,20 mètres du sol, de préférence dans un endroit accessible et propre. Votre armoire de décontamination doit fonctionner en position verticale, quel que soit le local dans lequel elle est installée.




L'appareil ARM ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.

En cas de doutes sur le positionnement, contactez votre vendeur ou un électricien habilité pour conseil avant installation

INSTALLATION

1. Fixer 4 vis + chevilles en suivant le plan ci-contre
2. Accrocher l'appareil en insérant les vis dans les boutonnières
3. Ouvrir l'appareil et serrer les vis
4. Refermer puis brancher l'appareil
5. Régler un cycle de stérilisation après à la mise sous tension.

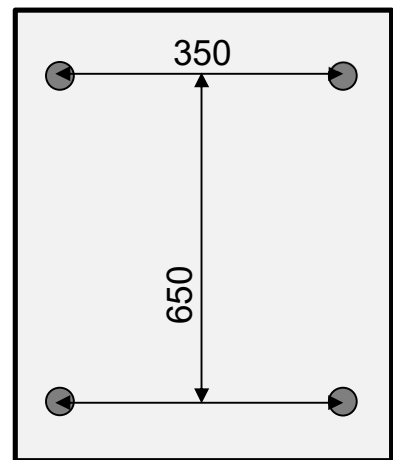

MAINTENANCE

LE REMPLACEMENT DE LA LAMPE UV-C PAR UN UTILISATEUR NON QUALIFIE EST INTERDIT.

L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation avant toute opération de maintenance, y compris le remplacement de la lampe UV-C. Pour maintenir une efficacité optimale, la lampe UV-C doit être remplacée au moins 1 fois par an.

NETTOYAGE

Le nettoyage interne de l'appareil ne doit être fait qu'avec un chiffon légèrement humide, toute projection d'eau interne est à proscrire. Le nettoyage externe de l'appareil peut être fait au jet d'eau, à la condition impérative que la porte de l'appareil soit fermée.

GARANTIE


Votre Armoire est garantie 2 ans, à l'exclusion des lampes UVC.

En cas de panne de ce produit, prenez contact avec votre fournisseur qui le remplacera après s'être assuré qu'il a été utilisé dans les conditions normales.

<u>MODELES</u>	ARM50FA	ARM50FAS (S=fermeture par serrure)	KS20FA	KS20FAS (S=fermeture par serrure)
Minuterie	Classique	Classique	Automatique	Automatique
Capacité max. (couteaux)	6 à 8	6 à 8	6 à 8	6 à 8
Lampe UV	1x15W	1x15W	1x15W	1x15W
Haut. x Prof. x Larg. (en mm)	996 x 145 x 495	996 x 145 x 495	996 x 145 x 495	996 x 145 x 495
Poids (kg)	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg

30.03.2022


Indice B

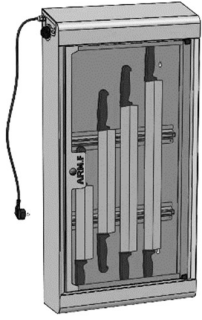

INSTRUCTIONS FOR USE

Long Knives Steriliser

ARM50FA / KS20FA

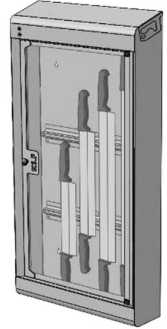

THIS INSTRUCTIONS MUST BE READ BEFORE ANY USE OF THIS APPLIANCE

ARM / KS RANGE: WORKING PRINCIPLE

You have just purchased a Knives Sterilizer for Cheese knives and we hope that it will give complete satisfaction. The ARM devices are powerful sterilization tools. According to hygiene standards, this appliance provides excellent decontamination of utensils. The intern UV-C bulb emits rays (253nm) that destroy germs by killing cells that are exposed to.

USE

After having cleaned the utensils, place them into the enclosure and close the door.

ARM : Turn the timer to 2 hours, then a sterilizing cycle will start.

Each time the door will be opened before the end of a cycle, the appliance needs to be restarted by turning the timer to 2 hours. When a cycle pass through the end, the utensils are decontaminated and ready to use.

KS : After the door closing, the appliance will automatically start a sterilizing cycle of 2 hours.

Each time the door will be opened before the end of a cycle, it will restart a new cycle.

The two indicator lamps show the device state:

- GREEN OFF + RED OFF → the door is open or incorrectly closed
- GREEN OFF + **RED ON** → A sterilizing cycle is processing
- **GREEN ON** + RED OFF → Sterilization have been done, utensils are ready to use

use

When a cycle pass through the end, the utensils are decontaminated and ready to use.

IMPORTANT

This appliance can be used by children older than 8 years and by persons with diminished physical, sensory or mental capacities or no experience, only if they are correctly supervised or if they have been given the instructions on how to use the appliance with complete safety and if they understand the risks involved. Children mustn't play with this device. This device must be placed out of touching from children (seen "POSITIONING") Cleaning and servicing mustn't be made by user without knowledge of the specific processes (A2 / EN 60335-1).

PHOTOBIOLOGICAL SAFETY



This device enclose a UV-C emitting bulb. UV-C radiations are harmful for eyes and skin. This appliance construction ensure complete users safety against this radiations in normal using conditions. Indeed, a shutdown switch cut the bulb power each time the door is opened. Unappropriate using or a structure deterioration may occur some UV-C rays leaks.

NEVER use UV-C bulbs out of this enclosure.

NEVER start this device if it seems to be damaged.

NEVER tent to action the switch on when the appliance's door is opened.

POWER REQUIREMENTS

KS sterilizers are designed to operate from the following power supply: **220/240V – 50/60Hz**. Therefore, please ensure that the electricity supply in your premises is compatible with this device. **This appliance must imperatively be connected to an electric socket that is earthed and equipped by protective a 30mA residual-current device (RCD).**

POSITIONING


This device is only made to be used indoor and must be installed in vertical position. It has to be fixed to the wall at more the less than 1.20m, preferably in an accessible and clean area.



The units must only be used in areas which are free of dust and possible explosive vapour mixture. Should you have any queries contact your local reseller for advice before installation.

INSTALLATION

1. Fix the 4 screws and dowels according to plan bellow
2. Hang it by sliding screw's heads into corresponding holes
3. Open the door and tighten the screws to lock fixing
4. Connect the appliance to a power outlet corresponding to the power requirements
5. A sterilizing cycle will start automatically.

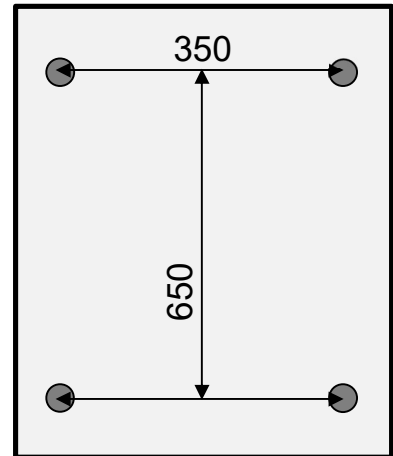

SERVICING

Changing of the UV-C bulb by any non-qualified user is strictly forbidden. Before any form of servicing, even like bulb replacement, the unit must be disconnected from the mains supply. To maintain the sterilizing efficiency, the UV-C bulbs have to be replaced once a year.

CLEANING

The internal cleaning of this device can only be made by using a slightly damp towel. Any internal or external water projection have to be avoided.

GUARANTEE

Your unit is guaranteed for 2 years (excluding bulbs replacement). If a fault occurs, contact your supplier, who will replace your unit checking that the product has been operated under normal conditions.

<u>MODELES</u>	ARM50FA	ARM50FAS (S= key closure)	KS20FA	KS20FAS (S= key closure)
Timer	Rotary handle	Rotary handle	Automatic	Automatic
Maximum knives	6 à 8	6 à 8	6 à 8	6 à 8
UVC Bulb	1x15W	1x15W	1x15W	1x15W
Height x Depth x Width (mm)	996 x 145 x 495	996 x 145 x 495	996 x 145 x 495	996 x 145 x 495
Weight (kg)	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg

30.03.2022
Indice B

BRC SAS – 21 rue des coteaux de Grand Lieux – 44830 BOUAYE
info@brcsa.com - Tel. 02 40 34 57 24 – Fax. 02 40 34 74 76 – www.brca.com